


Medicinteknisk avvikelse där arbetstekniskt hjälpmedel hyrt eller köpt från Sodexo Hjälpmedelsservice varit inblandat

Medicinteknisk avvikelse

En medicinteknisk avvikelse där hjälpmedel från Sodexo HJS varit inblandat **ska alltid** rapporteras i vårdgivarens avvikelssystem enligt kommunernas/ Region Östergötlands rutin.

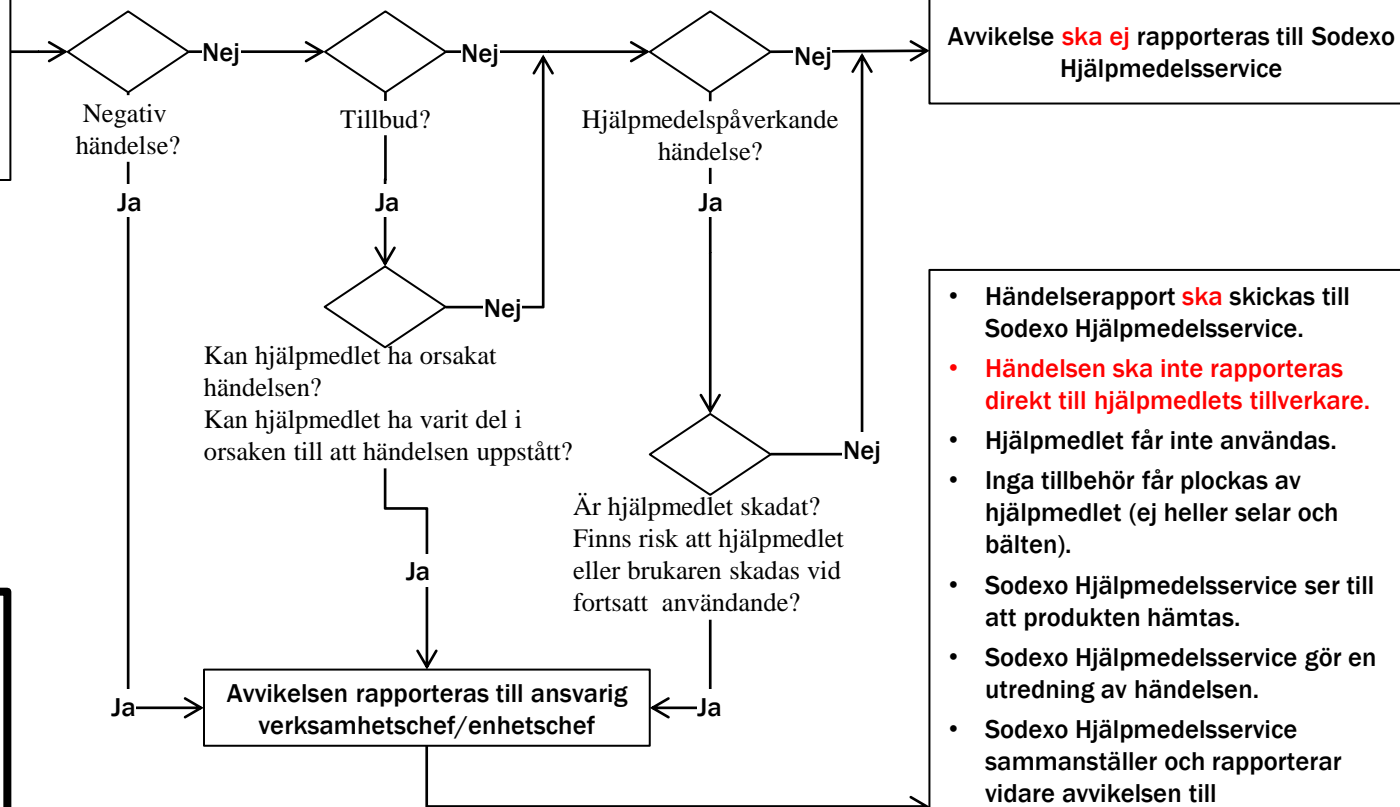

Medicinteknisk avvikelse

En medicinteknisk avvikelse klassificeras i tre olika kategorier:

Negativ händelse

En negativ händelse är en händelse som medfört vårdskada

Tillbud

Ett tillbud är en händelse som kunnat medföra vårdskada

Hjälpmedelspåverkande händelse

En händelse som medfört skada på hjälpmedel och som innebär risk för brukaren vid fortsatt användande

Avvikelse **ska ej** rapporteras till Sodexo Hjälpmedelsservice

- Händelserapport **ska** skickas till Sodexo Hjälpmedelsservice.
- **Händelsen ska inte rapporteras direkt till hjälpmedlets tillverkare.**
- Hjälpmedlet får inte användas.
- Inga tillbehör får plockas av hjälpmedlet (ej heller selar och bälten).
- Sodexo Hjälpmedelsservice ser till att produkten hämtas.
- Sodexo Hjälpmedelsservice gör en utredning av händelsen.
- Sodexo Hjälpmedelsservice sammanställer och rapporterar vidare avvikelsen till läkemedelsverket och leverantör.
- Då svar erhålls från läkemedelsverket delges anmälaren och MAS/MAR.

Uppdaterad: 22-03-01